


# 仿單標籤粘貼表

產品名稱	"信東"血液過濾液5號	申請廠商	信東化學工業股份有限公司
------	-------------	------	--------------

衛生署給證號碼	衛署藥製字第036578號
---------	---------------

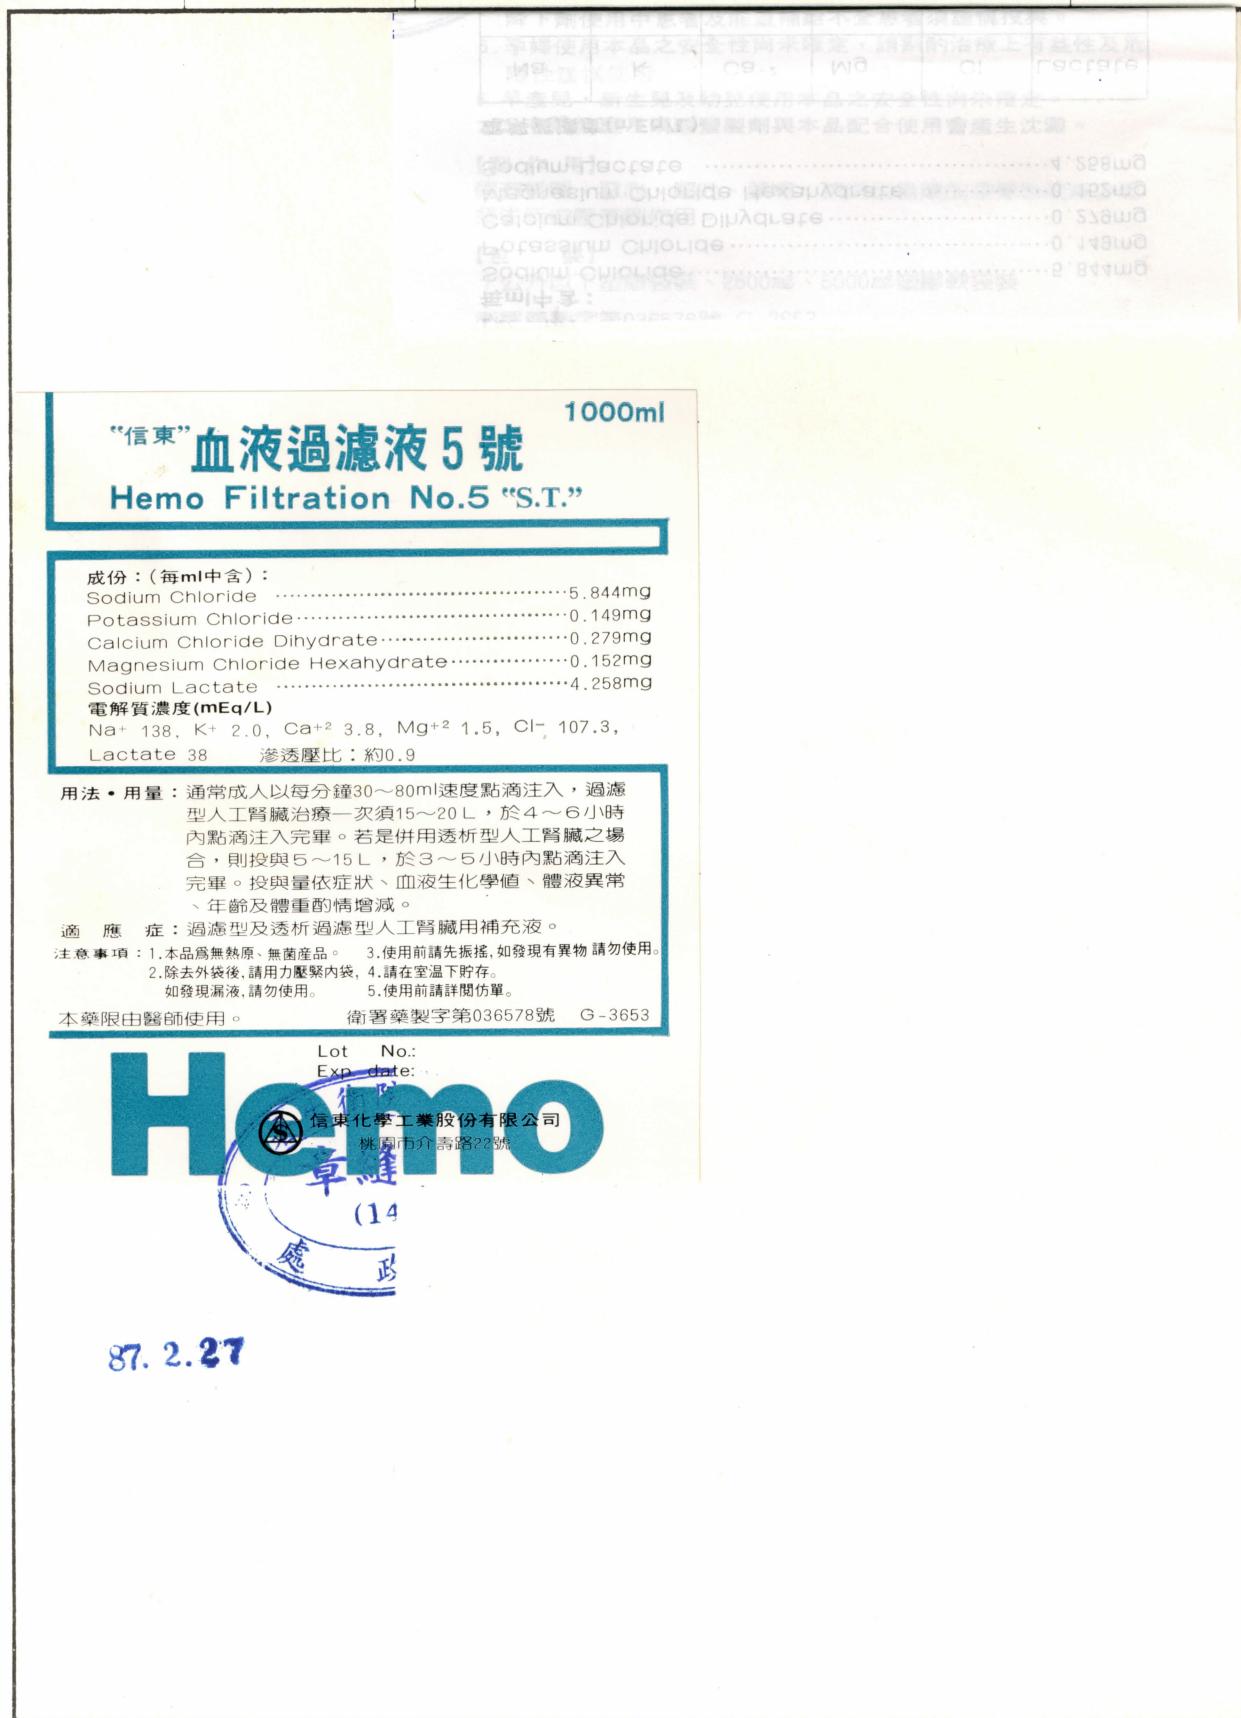

註

- (1)報核仿單標籤以粘貼全型為原則。  
(2)仿單標籤等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於  
粘貼時附送現品並將照相影本代替粘貼報核。

“信東”血液過濾液 5 號  
Hemo Filtration No.5 “S.T.”

2500ml

成份：(每ml中含)：  
Sodium Chloride ..... 5.844mg  
Potassium Chloride ..... 0.149mg  
Calcium Chloride Dihydrate ..... 0.279mg  
Magnesium Chloride Hexahydrate ..... 0.152mg  
Sodium Lactate ..... 4.258mg  
電解質濃度(mEq/L) .....  
Na<sup>+</sup> 138, K<sup>+</sup> 2.0, Ca<sup>+2</sup> 3.8, Mg<sup>+2</sup> 1.5, Cl<sup>-</sup> 107.3,  
Lactate 38 滲透壓比：約0.9

用法・用量：通常成人以每分鐘30～80ml速度點滴注入，過濾型人工腎臟治療一次須15～20L，於4～6小時內點滴注入完畢。若是併用透析型人工腎臟之場合，則投與5～15L，於3～5小時內點滴注入完畢。投與量依症狀、血液生化學值、體液異常、年齡及體重酌情增減。

適應症：過濾型及透析過濾型人工腎臟用補充液。

注意事項：1. 本品為無熱原、無菌產品。 3. 使用前請先振搖，如發現有異物請勿使用。  
2. 除去外袋後，請用力壓緊內袋。 4. 請在室溫下貯存。  
如發現漏液，請勿使用。 5. 使用前請詳閱仿單。

本藥限由醫師使用。 衛署藥製字第036578號 G-3653

Lot No.:  
Exp. date:

Hemo

信東化學工業股份有限公司  
桃園市介壽路22號

87.2.27

“信東”血液過濾液 5 號  
Hemo Filtration No.5 “S.T.”

5000ml

成份：(每ml中含)：  
Sodium Chloride ..... 5.844mg  
Potassium Chloride ..... 0.149mg  
Calcium Chloride Dihydrate ..... 0.279mg  
Magnesium Chloride Hexahydrate ..... 0.152mg  
Sodium Lactate ..... 4.258mg  
電解質濃度(mEq/L)  
Na<sup>+</sup> 138, K<sup>+</sup> 2.0, Ca<sup>+2</sup> 3.8, Mg<sup>+2</sup> 1.5, Cl<sup>-</sup> 107.3,  
Lactate 38 滲透壓比：約0.9

用法・用量：通常成人以每分鐘30～80ml速度點滴注入，過濾型人工腎臟治療一次須15～20L，於4～6小時內點滴注入完畢。若是併用透析型人工腎臟之場合，則投與5～15L，於3～5小時內點滴注入完畢。投與量依症狀、血液生化學值、體液異常、年齡及體重酌情增減。

適應症：過濾型及透析過濾型人工腎臟用補充液。

注意事項：1. 本品為無熱原、無菌產品。 3. 使用前請先振搖，如發現有異物請勿使用。  
2. 除去外袋後，請用力壓緊內袋。 4. 請在室溫下貯存。  
如發現漏液，請勿使用。 5. 使用前請詳閱仿單。

本藥限由醫師使用。 衛署藥製字第036578號 G-3653

Lot No.:  
Exp. date:

Hemo

信東化學工業股份有限公司  
桃園市介壽路22號